


ONDERHOUDS- EN WAARBORGBOEKJE

ADMINISTRATIEVE PATIENTENGEGEVENS


NAAM :
ADRES :
TEL. :
GEBOORTEDATUM :
KLEEFBRIEFJE V.I. :

GEWICHT : kg
ACTIVITEIT :
BEROEP, HOBBY'S :

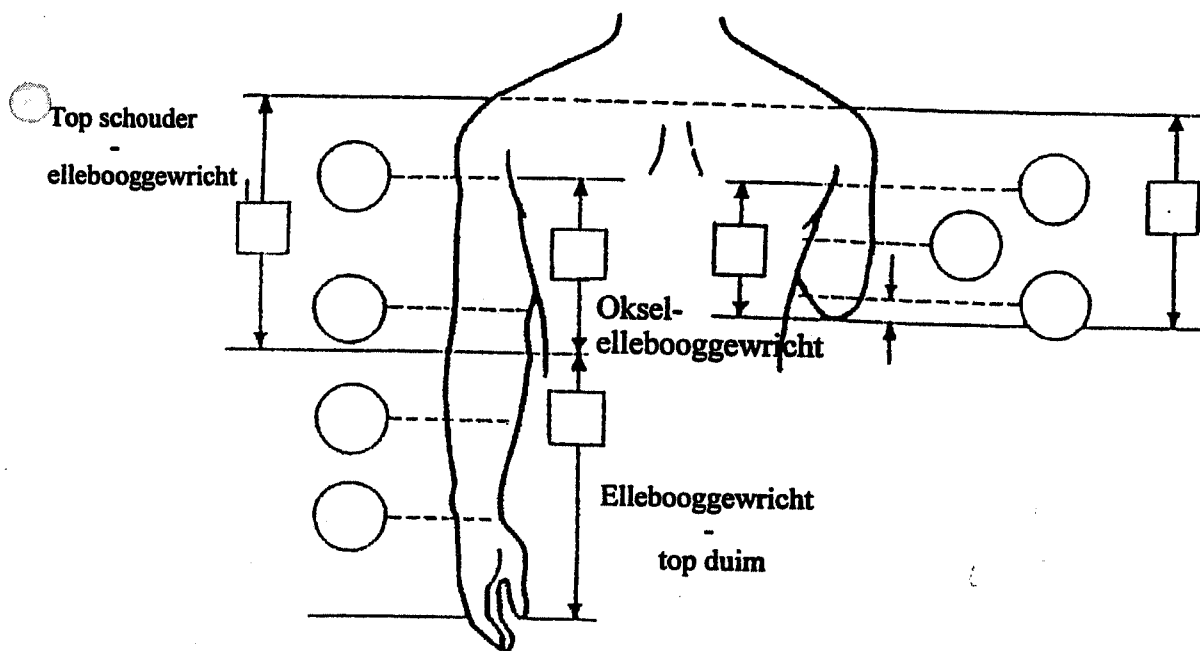

Handomvang, gemeten zonder duimen
cm

Handschoengrootte

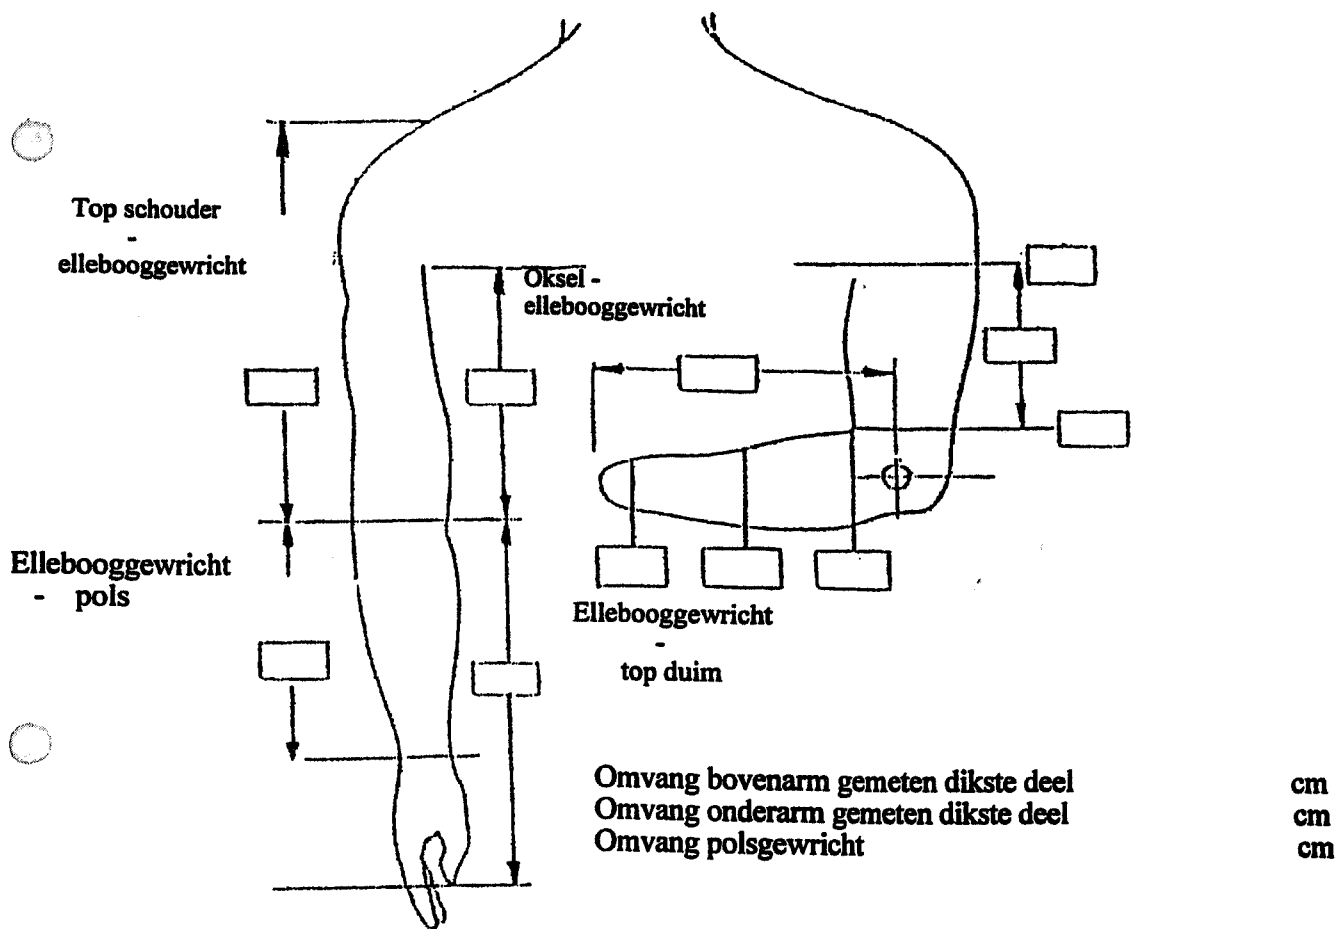

Handomvang, gemeten zonder duimen
cm

Handschoengrootte

TYPE VAN PROTHESE

- SYSTEEM :**
- digitaal, passieve pro- en supinatie
 - digitaal, tweedelige koker
 - digitaal, combinatie schakelaar met myoprothese
 - dubbelkanaal, passieve pro- en supinatie
 - dubbelkanaal, tweedelige koker
 - schakelaars, passieve pro- en supinatie
 - schakelaars, actieve pro- en supinatie
-
- actieve pro- en supinatie
 - D.M.C.
 - grijper
 - ellebooggewricht met lifter
 - myo-elektrisch ellebooggewricht (bij bilaterale amputatie)
 - ellebooggewricht met vergrendeling voor myo-elektrische armprothese
 - schoudergewricht.

DATUM VAN DE AFLEVERING :

IDENTIFICATIE VAN DE VERSTREKKER :

DE GEBRUIKTE MYO-ELEKTRISCHE ONDERDELEN

Artikelnr. Benaming Aantal Serienr. Verdeler

Handschoentype :

DE OPVOLGING VAN HET 6-MAANDELIJKS NAZICHT EN ONDERHOUD

DATUM VAN AFLEVERING :
DATUM VOLGENDE ONDERHOUD :

Handtekening patiënt : verstrekker :



DATUM ONDERHOUD 1 :
DATUM VOLGENDE ONDERHOUD :
BESCHRIJVING ONDERHOUD :

Handtekening

patiënt :

verstrekker :



DATUM ONDERHOUD 2 :
DATUM VOLGENDE ONDERHOUD :
BESCHRIJVING ONDERHOUD :



Handtekening

patiënt :

verstrekker :

DATUM ONDERHOUD 3 :
DATUM VOLGENDE ONDERHOUD :
BESCHRIJVING ONDERHOUD :

Handtekening patiënt : verstrekker :

DATUM ONDERHOUD 4 :
DATUM VOLGENDE ONDERHOUD :
BESCHRIJVING ONDERHOUD :

Handtekening patiënt : verstrekker :

DATUM ONDERHOUD 5 :
DATUM VOLGENDE ONDERHOUD :
BESCHRIJVING ONDERHOUD :

Handtekening

patiënt :

verstrekker :

DATUM ONDERHOUD 6 :
DATUM VOLGENDE ONDERHOUD :
BESCHRIJVING ONDERHOUD :

Handtekening

patiënt :

verstrekker :

DATUM ONDERHOUD 7 :
DATUM VOLGENDE ONDERHOUD :
BESCHRIJVING ONDERHOUD :

Handtekening patiënt : verstrekker :

DATUM ONDERHOUD 8 :
DATUM VOLGENDE ONDERHOUD :
BESCHRIJVING ONDERHOUD :

Handtekening patiënt : verstrekker :

BESCHRIJVING VAN DE UITGEVOERDE HERSTELLINGEN

DATUM HERSTELLING :
BESCHRIJVING DEFEKT :
BESCHRIJVING HERSTELLING :



Handtekening

patiënt :

verstrekker :

DATUM HERSTELLING :
BESCHRIJVING DEFEKT :
BESCHRIJVING HERSTELLING :



Handtekening

patiënt :

verstrekker :

DATUM HERSTELLING :
BESCHRIJVING DEFEKT :
BESCHRIJVING HERSTELLING :

Handtekening

patiënt :

verstrekker :

DATUM HERSTELLING :
BESCHRIJVING DEFEKT :
BESCHRIJVING HERSTELLING :

Handtekening

patiënt :

verstrekker :

DATUM HERSTELLING :
BESCHRIJVING DEFEKT :
BESCHRIJVING HERSTELLING :

Handtekening

patiënt :

verstrekker :

DATUM HERSTELLING :
BESCHRIJVING DEFEKT :
BESCHRIJVING HERSTELLING :

Handtekening

patiënt :

verstrekker :

DATUM HERSTELLING :
BESCHRIJVING DEFEKT :
BESCHRIJVING HERSTELLING :

Handtekening

patiënt :

verstrekker :

DATUM HERSTELLING :
BESCHRIJVING DEFEKT :
BESCHRIJVING HERSTELLING :

Handtekening

patiënt :

verstrekker :

DE WAARBORGMODALITEITEN, ZOALS BEPAALD IN DE NOMENCLATUUR

- 1) De waarborg geldt exclusief de produktwaarborg van de producent van het myo-elektrisch gedeelte. De verstrekker treedt bemiddelend op als zich problemen voordoen in verband met de produktwaarborg.
- 2) De geleverde verstrekkingen, wat de juiste assemblage en de functionele anatomische aanpassing betreft (maatwerk) met aanvankelijk goede werking, zijn gedurende 6 maanden gewaarborgd na de levering of na elk onderhoud.
- 3) Om vroegtijdig defekten en slijtage op te sporen en te voorkomen, wordt een systeem met nazichtbeurt om de 6 maanden opgelegd. (verstrekkingen 655513 en 655535)
- 4) Het onderhoud en nazicht dient telkens te gebeuren in de loop van de 6^{de} of de 7^{de} maand. De periodes van 6 maanden worden gerekend vanaf de datum van de levering van de volledige prothese.

DE ONDERHOUDS- EN ZORGVORSCHRIFTEN VOOR DE PATIENT

A) OPGELET

1. vochtbestendigheid

- de elektronika en de mechaniek van uw elektrohand + grijper is niet waterbestendig. U moet voorkomen dat er water of zand in de hand terechtkomt. Handelingen zoals het wassen van uw elektrohand en afwassen, kunt U verrichten, maar let er altijd op dat er geen water in het mechanisme van de hand komt via eventuele beschadigingen aan de cosmetische handschoen of via de bovenkant van de koker.
- het volledig onderdompelen in vloeistoffen, leidt tot beschadiging van de grijper. Ingedrongen vocht of spatwater kan best door natuurlijke ventilatie opdrogen.

2. de hand : nooit als gereedschap gebruiken (hamer, hevel, enz.)

3. elektrodes : U mag zelf nooit de elektrodes instellen.

B) ONDERHOUD EN ZORG

1) batterij

- de batterijen steeds afwisselen in gebruik
- bij goed gebruik van de D.M.C.-hand en goede elektrode-instelling gaat een batterij \pm 1 dag mee
- bij D.M.C.-hand : wanneer de hand helemaal open gaat staan, bij te lage spanning, moet men de batterij verwisselen
- bij de conventionele hand : batterij verwisselen als de hand trager werkt of niet goed meer reageert.
- wanneer de prothese niet gebruikt wordt, moet de batterij steeds uitgehaald worden.

2) handschoen

- gedurende de eerste 2 weken moet de prothese 's nachts weggelegd worden in maximaal geopende stand : daardoor versoepelt de cosmetische handovertrek

- na 2 weken wordt de hand gewoon in de middenstand weggelegd.
- bij koud weer is het mogelijk dat de hand trager werkt wegens stijfheid van de handschoen.
- de handschoen kan gereinigd worden met speciale crème, waardoor ze ook soepel blijft.
- vlekken met stift, pen enz. : de vlek onmiddellijk schoonmaken met reinigingsdoekjes (geen agressieve producten gebruiken).

3) hand

Uw systeem elektrohand is uitgerust met een elektrische aan- en uitschakelaar, die onder de binnenhand is aangebracht en niet zichtbaar is aan de buitenkant. De handschakelaar dient gebruikt te worden als de hand gedurende langere tijd een bepaalde grijppositie aanneemt, zoals bijvoorbeeld bij het dragen van een tas, het vasthouden van bestek of het schrijven; hierdoor wordt de stroomtoevoer onderbroken en voorkomt U ongewenste bewegingen van de hand, die kunnen optreden door willekeurige spiersamentrekkingen of extreme elektrische storingen. Tevens gaat de batterij op deze manier ook langer mee.

4) elektrohand

Wees er op bedacht dat de prothese, de eerste 15 minuten na het aandoen nog niet optimaal functioneert. Dit komt, wegens het ontbreken van een transpiratiefilm tussen huid en elektroden. Deze transpiratiefilm werkt als een ideale geleider.